


CATÉTER PARA HISTEROSONOGRAFÍA



FICHA TÉCNICA

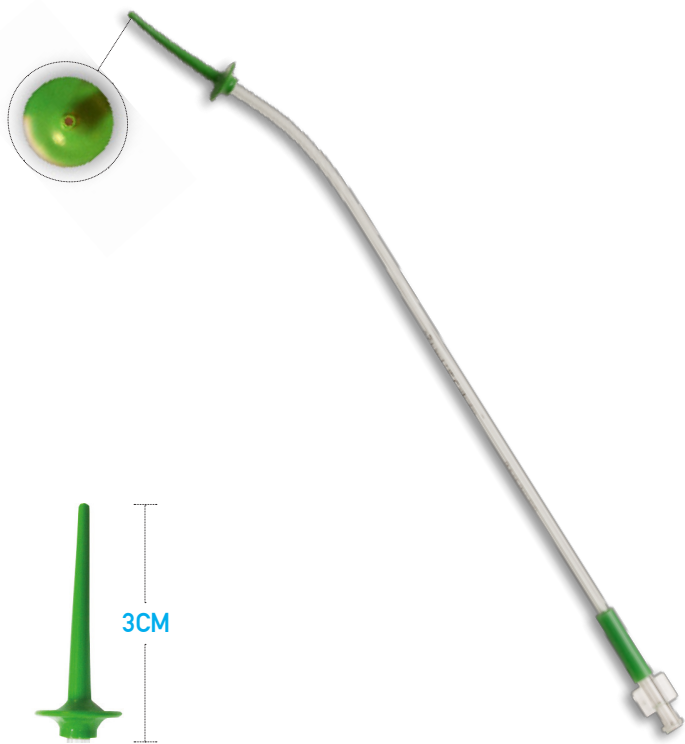

MARCA

MedGyn

CÓDIGO

022797

PRESENCIA DE LÁTEX

Libre de Látex

TIPO DE PRODUCTO

Producto de un solo uso, (desechable).

PRESENTACIÓN, ROTULADO Y TIPO DE ENVOLTORIO

Empaque individual tyvek grado médico, el cual garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto. Rotulado conforme las normativas sanitarias con presencia de N° de referencia, lote, fecha de caducidad y medio de esterilización.

MEDIDAS

2mm hasta 3.7mm

ESTERILIZACIÓN

Oxido de etileno (ETO)

PROCEDENCIA

Estados Unidos

DESCRIPCIÓN

Catéter de Histerosonografía, sin balón, un solo uso (desechable)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Punta especialmente diseñada que ayuda a prevenir fugas
- El diseño de su punta rígida con reborde permite una fácil colocación y uso por un solo operador
- La punta larga en el extremo distal mejora la colocación en el canal cervical
- Amplia apertura de la punta para un mayor flujo
- El catéter sin balón permite una visualización completa de la cavidad uterina durante el procedimiento

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

FDA y CE

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA MARCA MEDGYN

ISO 13485

EMPRESA DISTRIBUIDORA EN CHILE

IMH